C & U
CREATIVE & UNIQUE

MICRONIX

シグナルアナライザで測定したI/Qデータの外部転送

◇シグナルアナライザ（MSA500シリーズ）で測定したI/QデータをPCやUSBメモリに転送できます。

［アプリケーション　～*Application*～］

■接続模式図

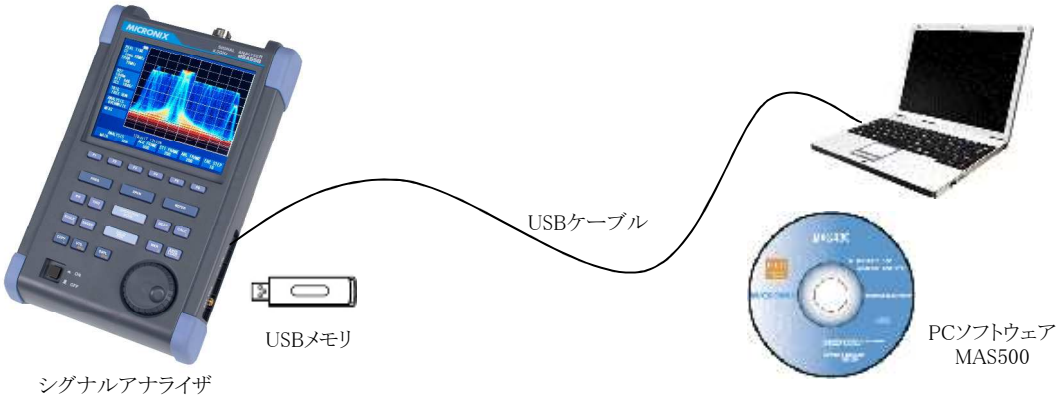

［ソリューション　～*Solution*～］

■シグナルアナライザの測定モードを、リアルタイムモードに設定します。

■メイン解析でタイムドメインの表示を選択して、データアクイジションを実行します。

■ 最大16,383フレームのI/Qデータを保存することができます。

■本体からUSBメモリに転送する場合

測定した全フレーム、あるいは一部のフレーム（任意の開始フレーム及び任意のフレーム数）のI/QデータをUSBメモリに転送することができます。

■PCソフトウェアによりUSBケーブル経由で取り込む場合

PCソフトウェア[MAS500]を使用することで、簡単にI/QデータをPCに取り込むことができます。

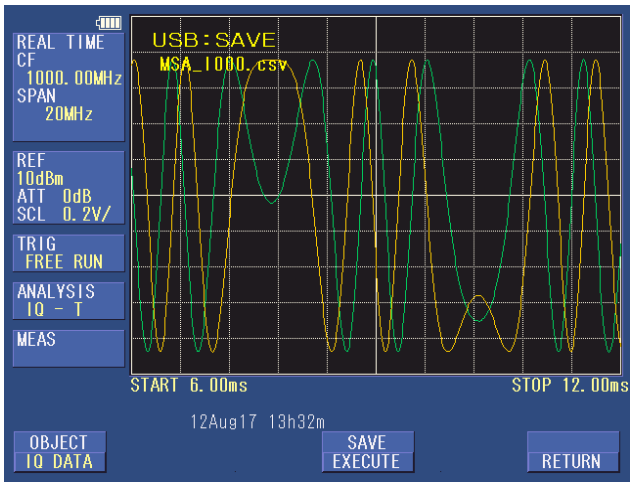

I/Qデータの測定例（I/Q対時間）

［システム構成・価格　～*System constitution＆Price*～］

スペクトラムアナライザ[MSA538]	×1	748,000
リチウムイオン電池 [MB400]	×1	21,600
USBケーブル [MI400]	×1	3,500
PCソフトウェア [MAS500]	×1	15,800
合計価格（税抜き）	¥	**788,900**

※詳細は弊社営業担当までお問合せ下さい。　※仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。

2015/1

マイクロニクス株式会社

〒193-0934　東京都八王子市小比企町2987-2
TEL. 042-637-3667　FAX. 042-637-0227

URL　http://www.micronix-jp.com
E-mail　micronix_j@micronix-jp.com